
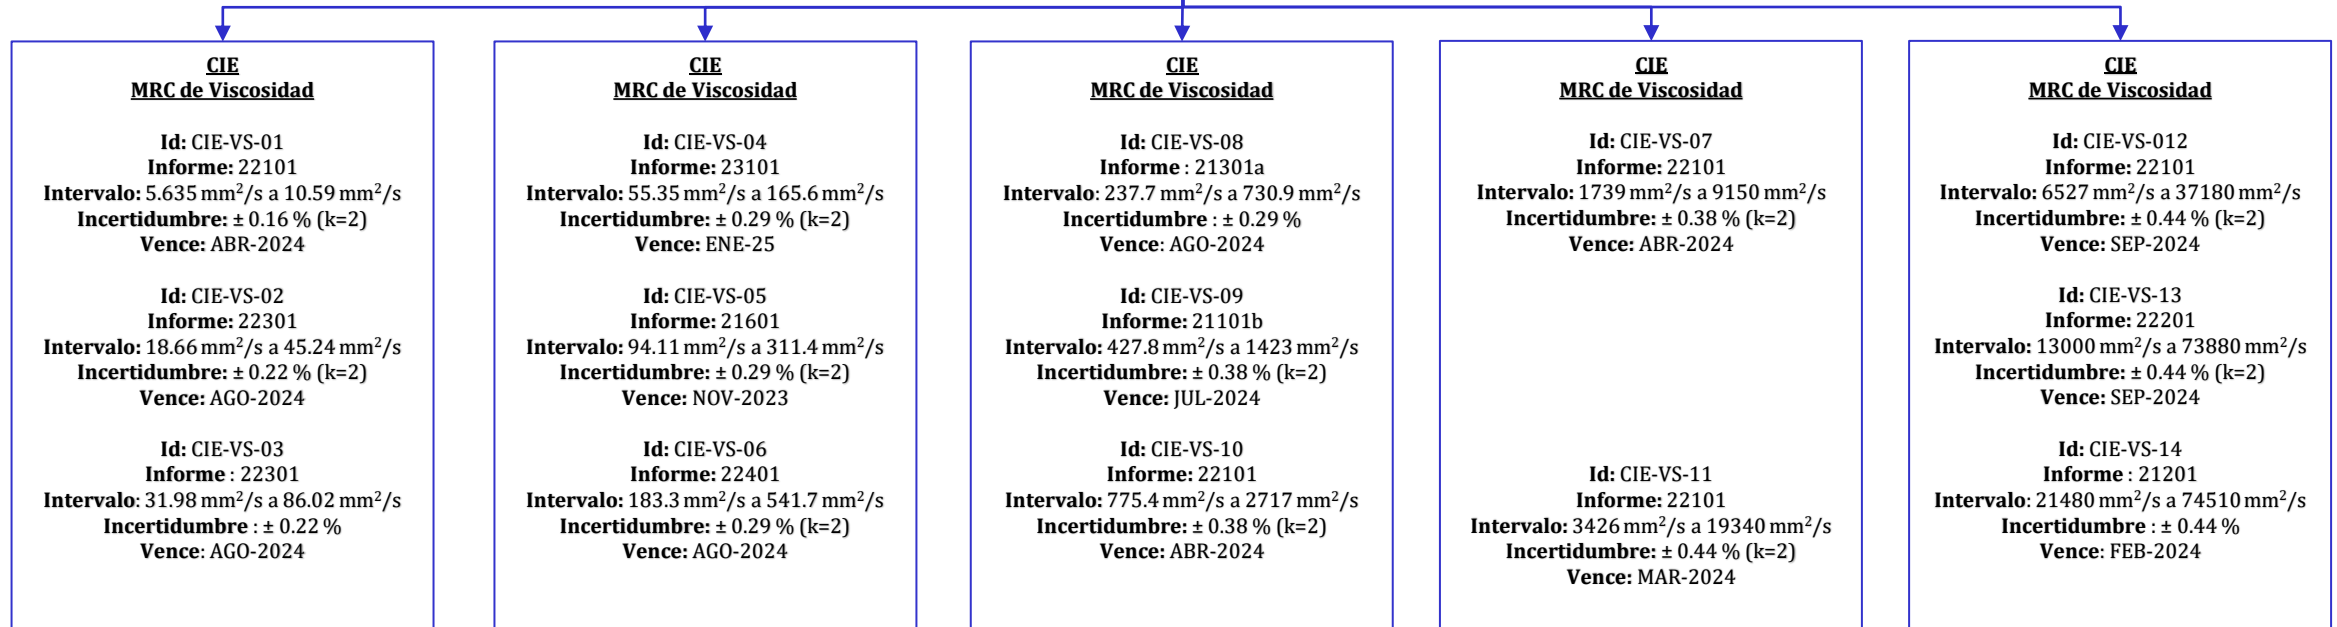


# CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

## CARTA DE TRAZABILIDAD VISCOSIDAD

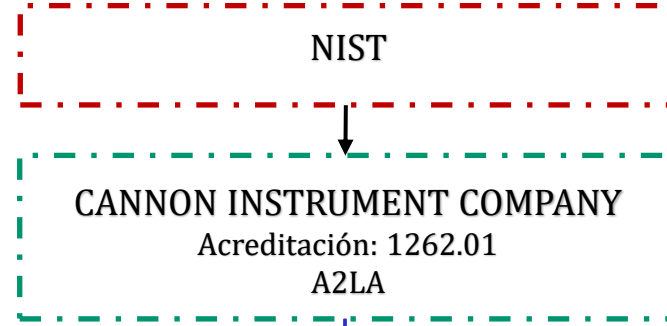

**MRC:** Material de Referencia Certificado.  
**Incertidumbre Expandida:** Los valores de la incertidumbre expandida consideran que el intervalo de temperatura de uso del MRC se encuentra entre 20 °C y 40 °C.  
**Intervalo:** El intervalo de viscosidad se corresponden con los valores de temperatura de 40 °C y 20 °C (25 °C para CIE-VIS-14).

**Copas para la medición de viscosidad**  
**Viscosímetros Rotacionales**

ELABORO:  
ALFREDO BARRANCO PALAFOX  
RESPONSABLE TÉCNICO

FECHA ELAB: MARZO 2023  
FECHA VENC: NOVIEMBRE 2023