


CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION

CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN DIFERENCIAL

(49.70 a 7459.10) Pa

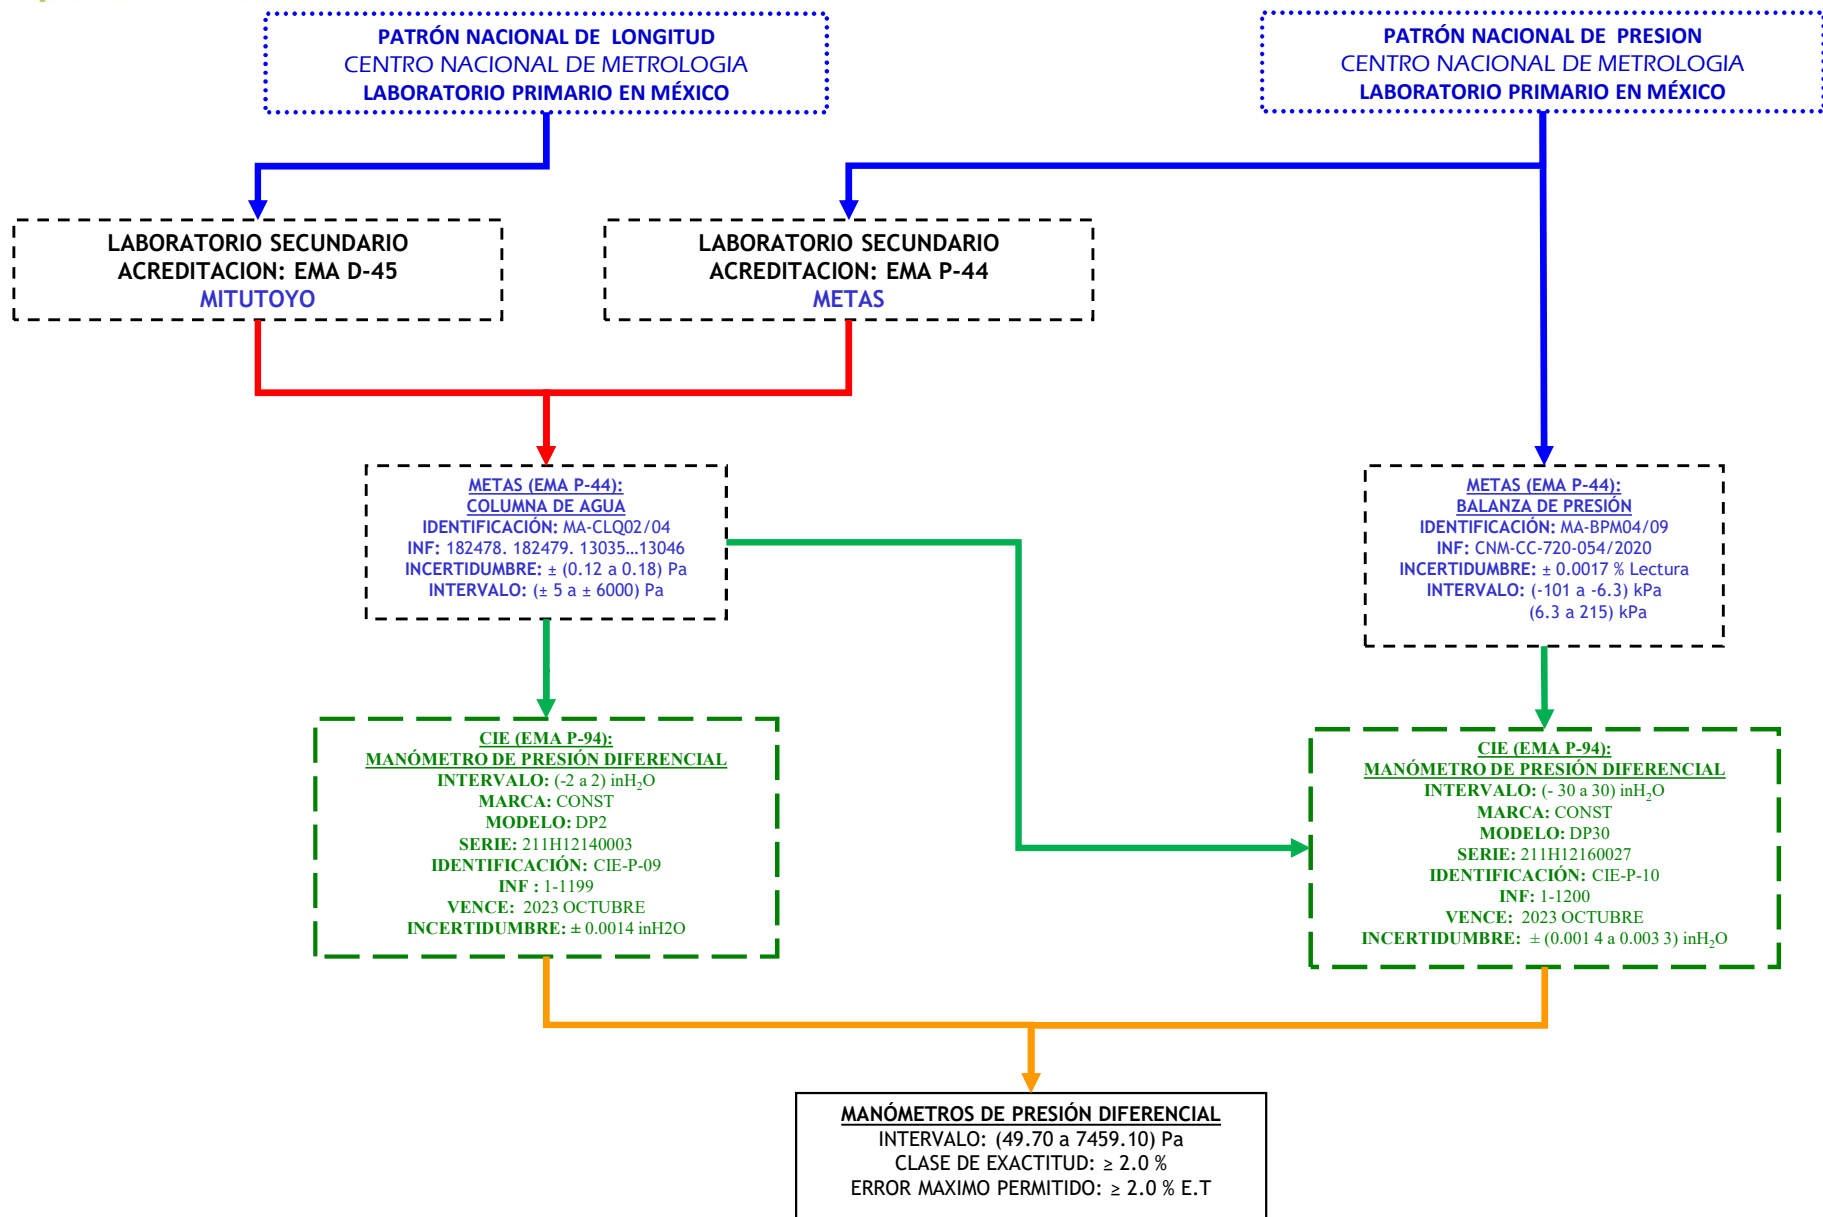




CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION

CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA

(-68.95 a 206.84) kPa

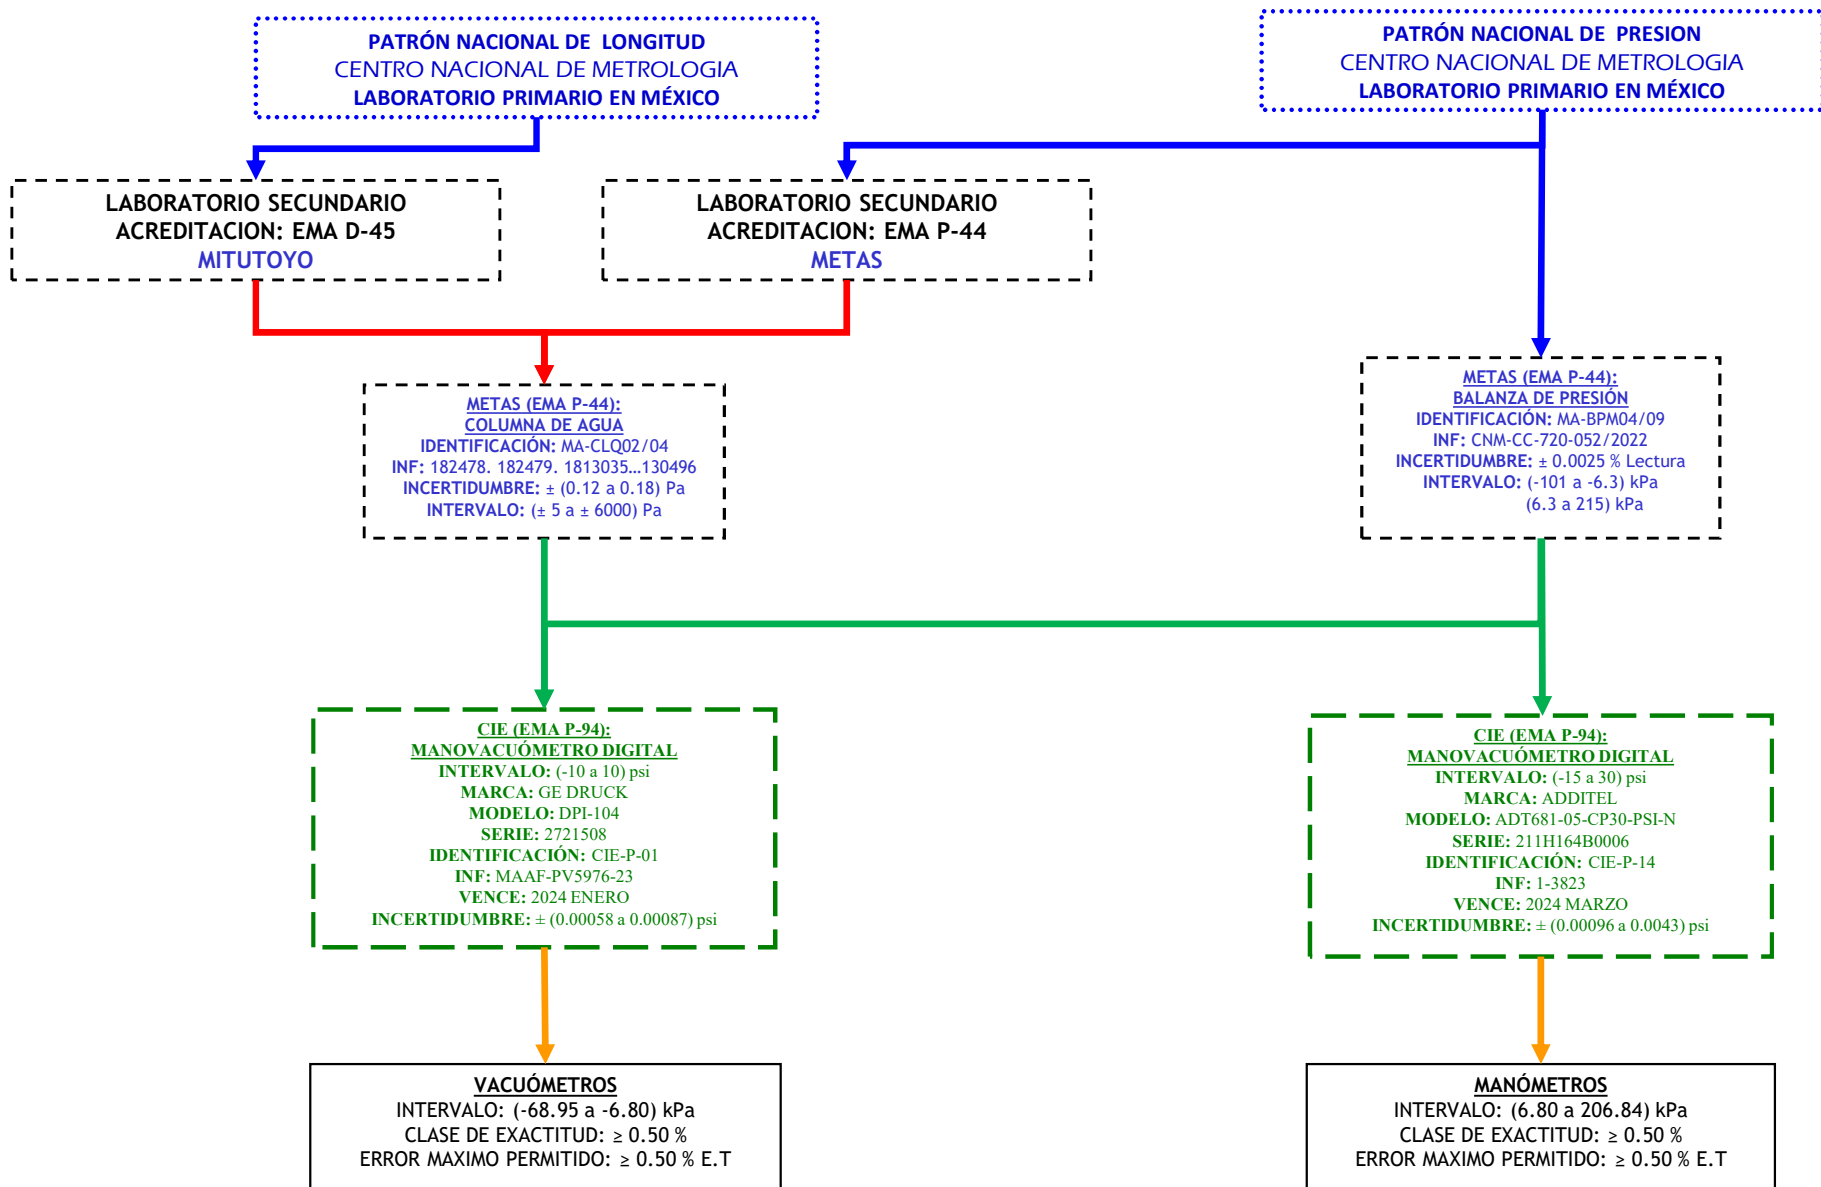




CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION


CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA (206.85 a 689.47) kPa

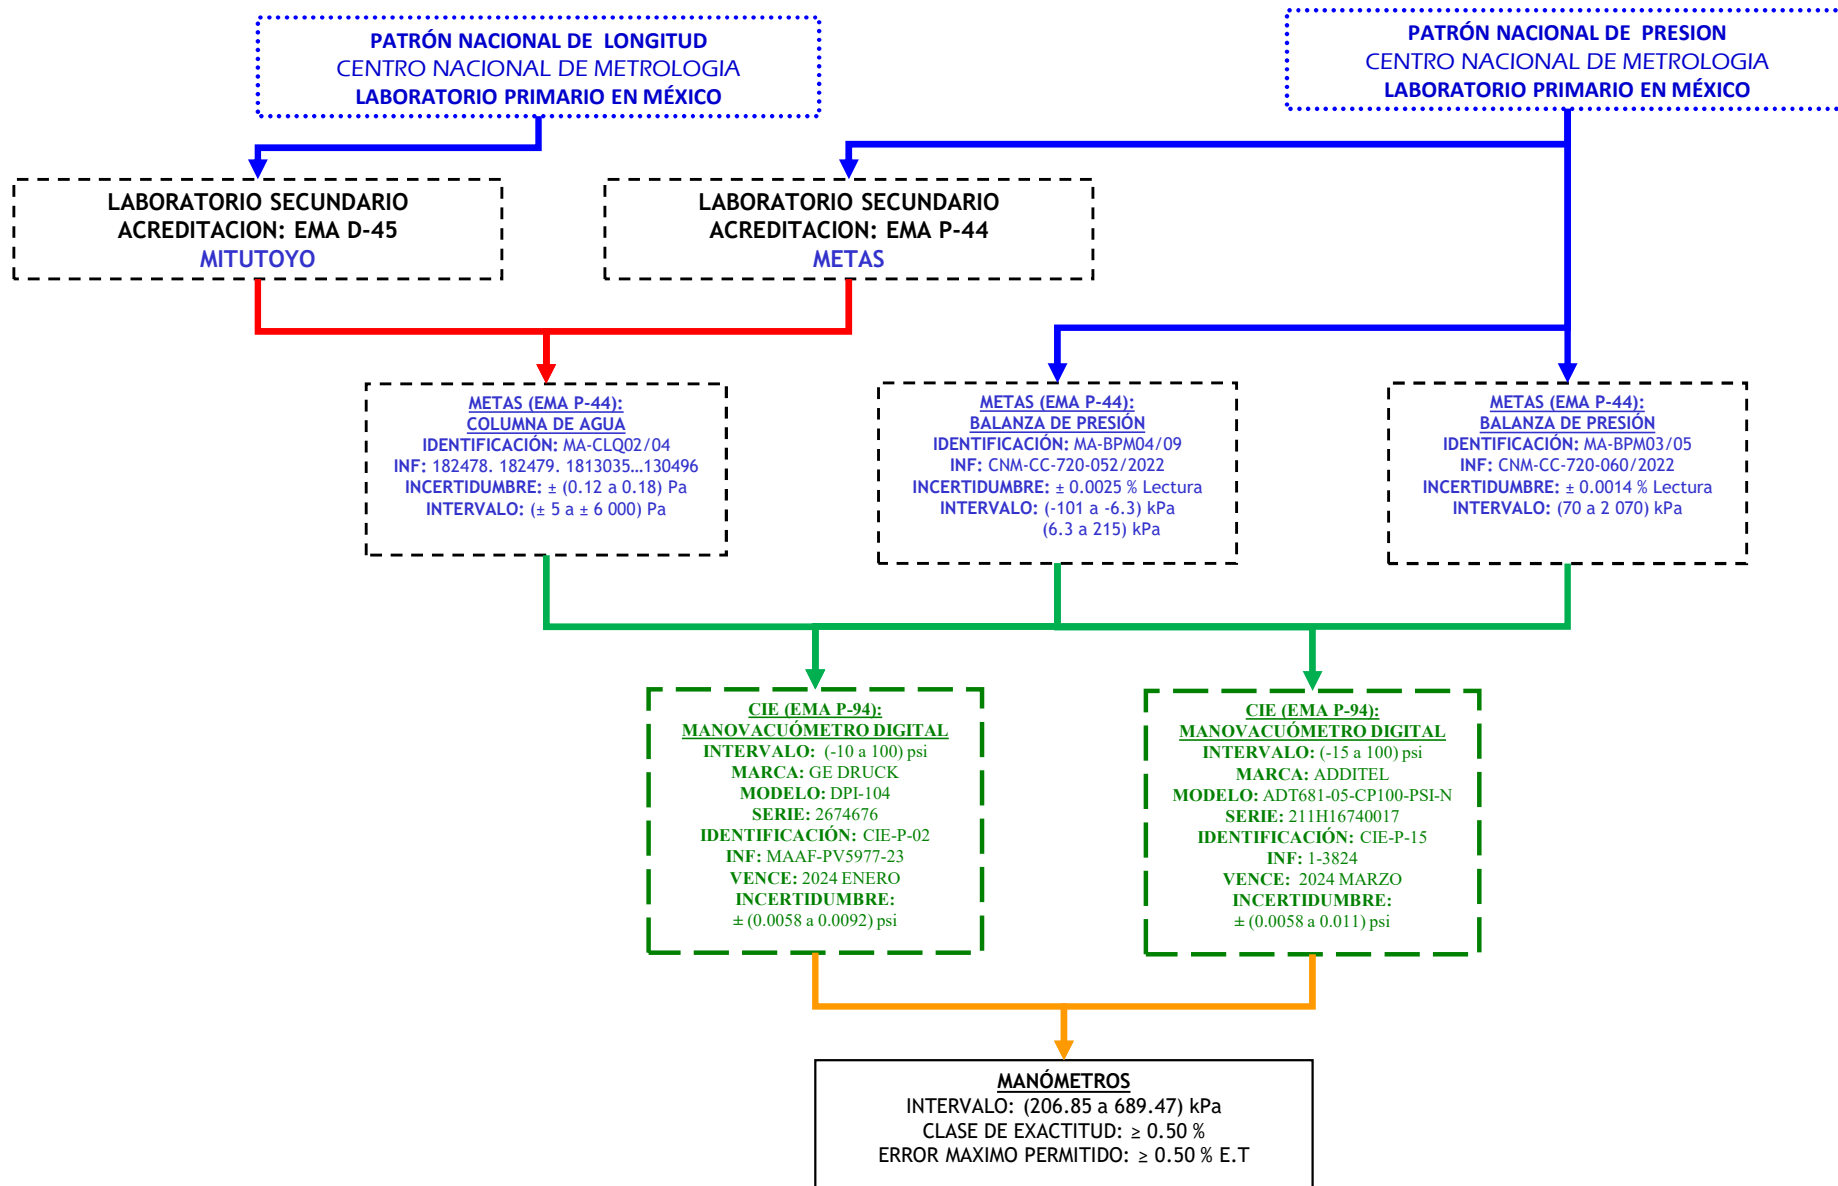

CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION


CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA (689.48 a 6894.75) kPa

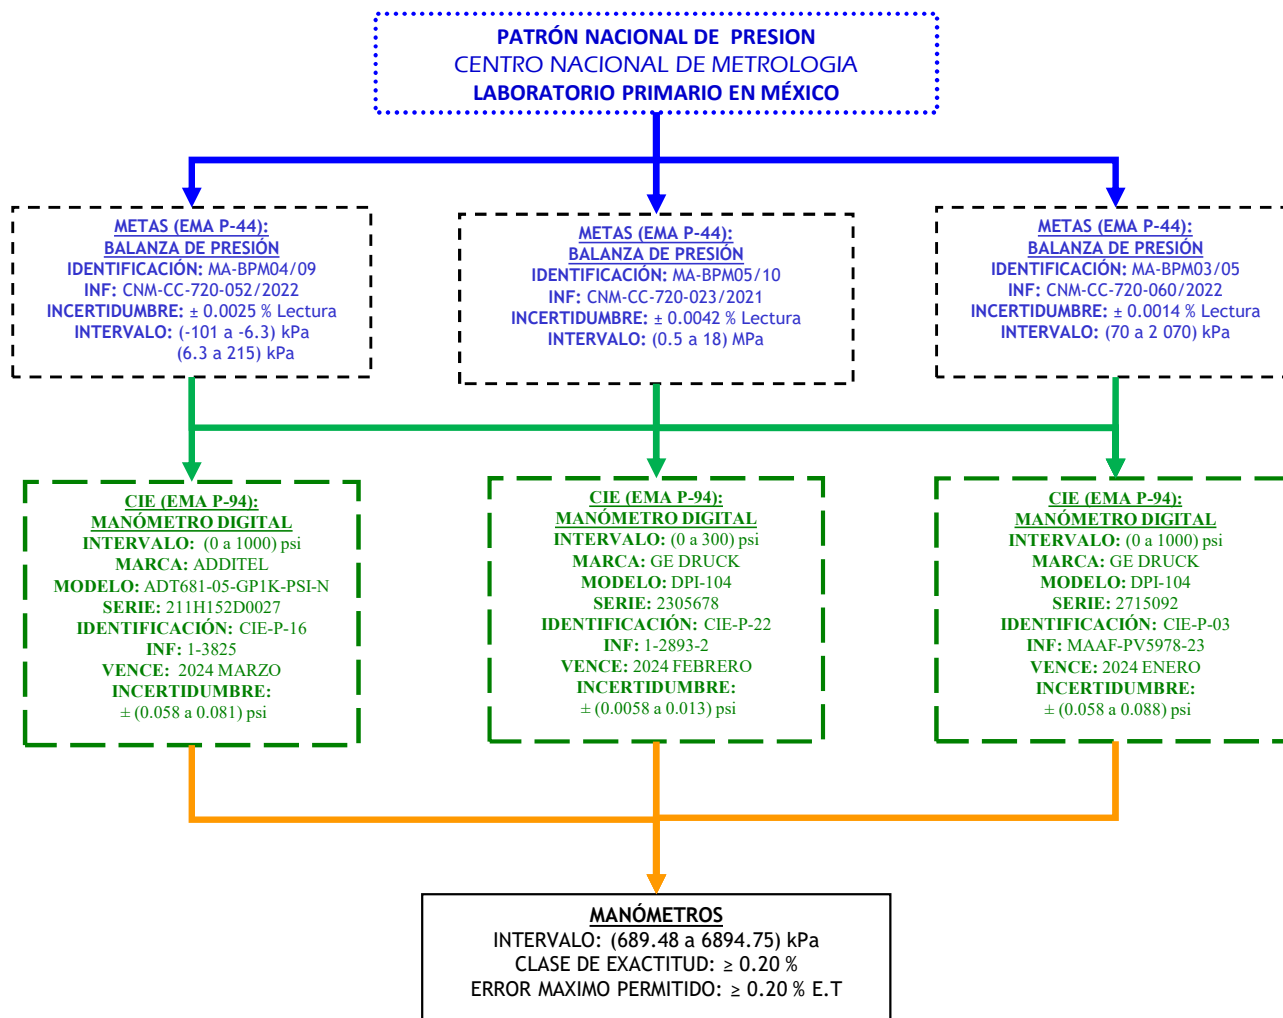

CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION

CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA (6894.76 a 137895.15) kPa

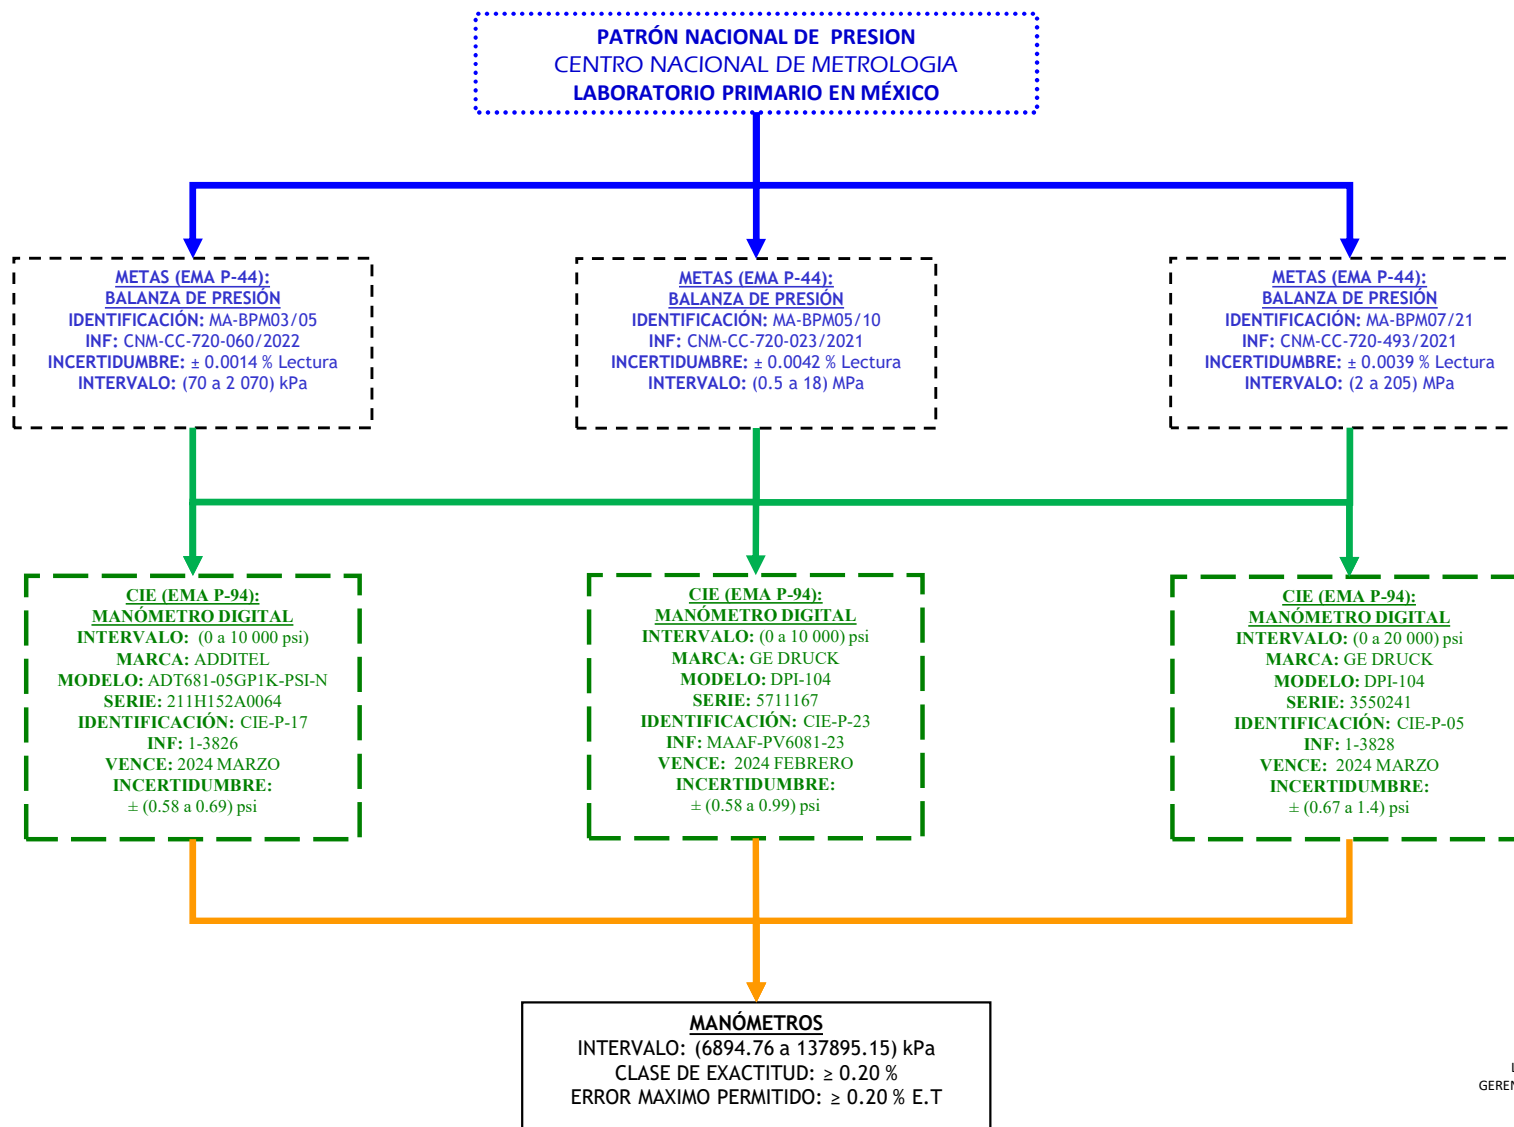

ELABORO:

LUIS FONT AVILA
GERENTE DE LABORATORIO



FECHA ELAB: MARZO 2023
FECHA VENCE: OCTUBRE 2023