




CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION

CARTA DE TRAZABILIDAD CARACTERIZACIONES DE TEMPERATURA 238.15 K a 873.15 K (-35.00 °C a 600.00 °C)

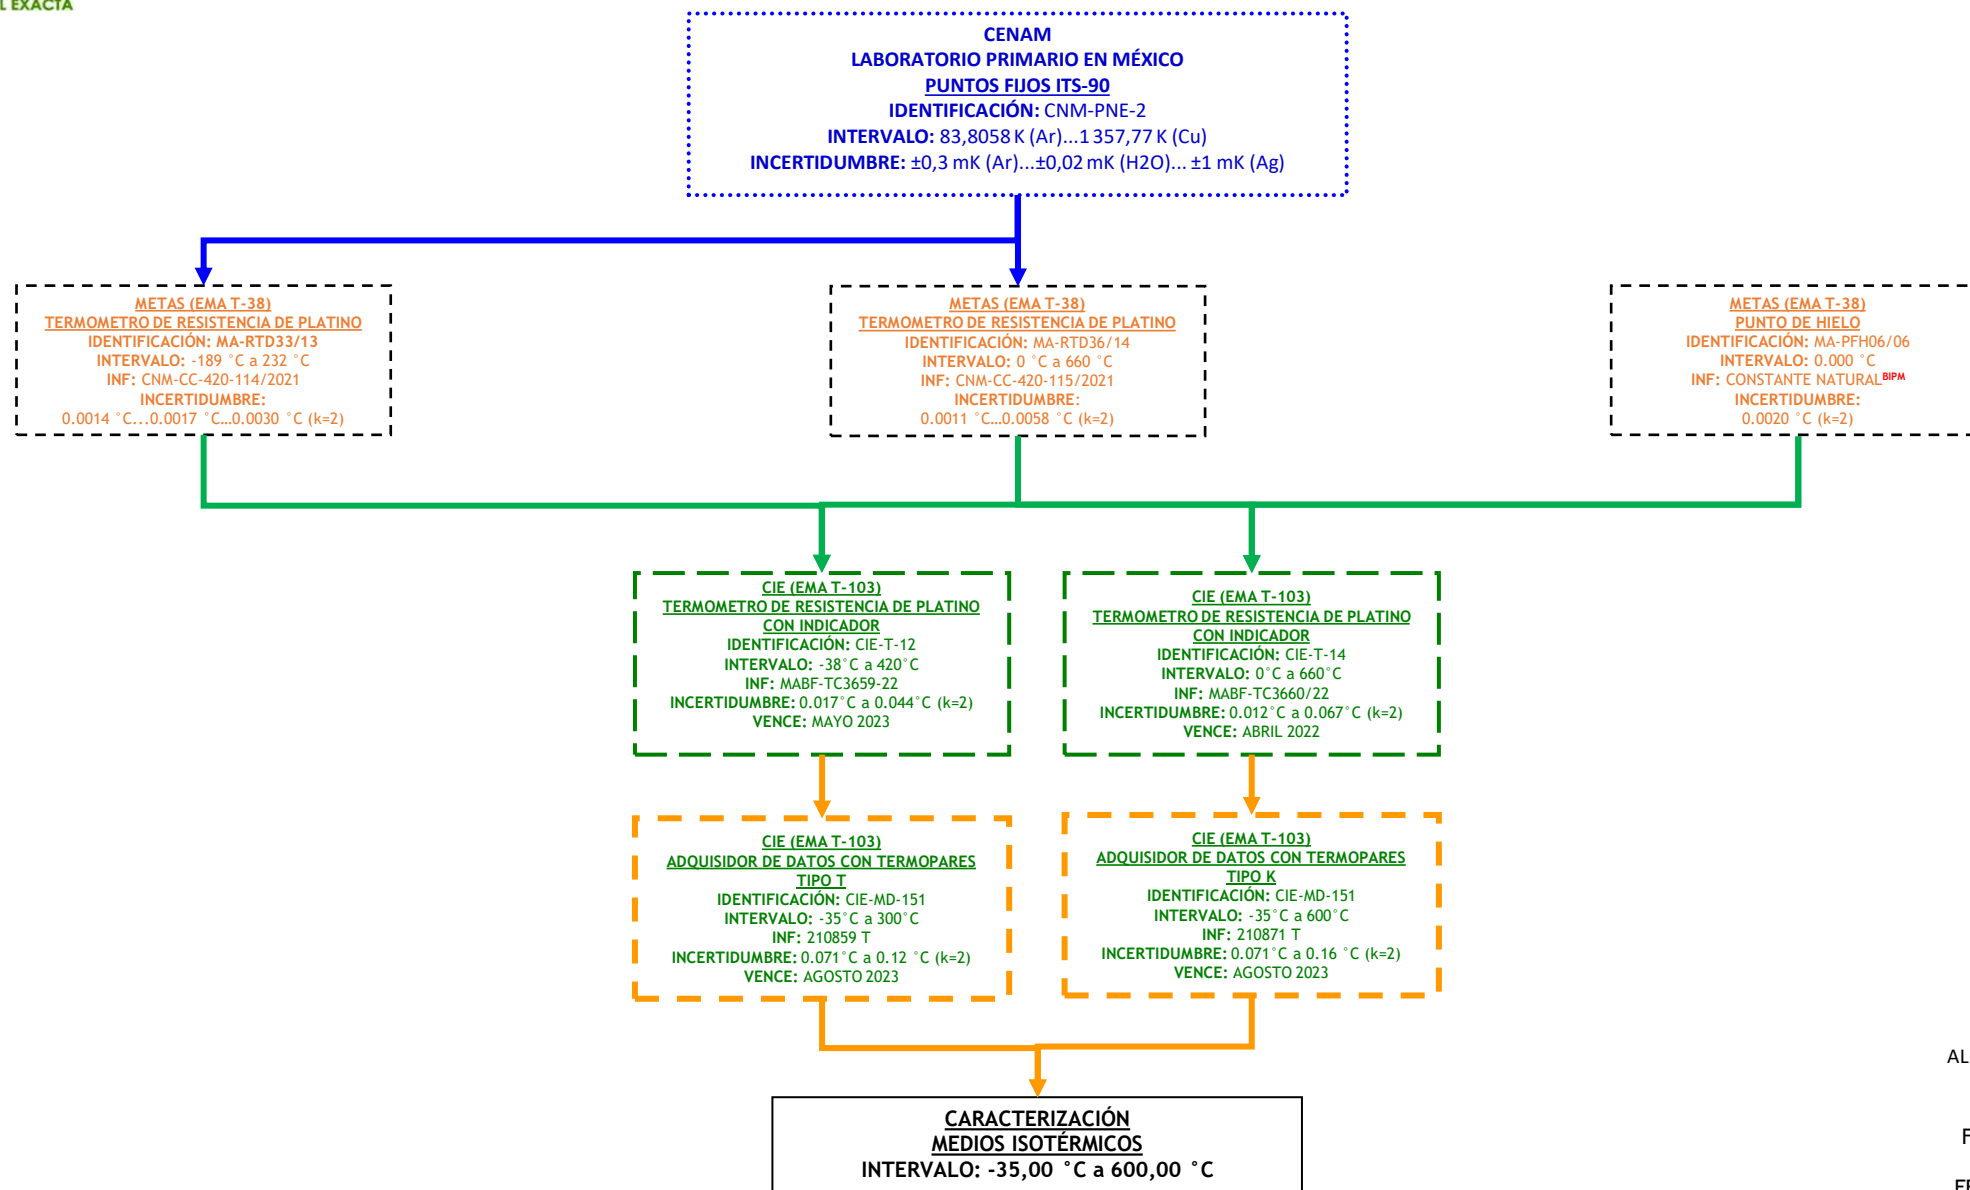

ELABORO:

ALEJANDRO POSADAS NATIVITAS
RESPONSABLE TÉCNICO

FECHA ELAB: AGOSTO 2022


FECHA VENCE: AGOSTO 2023



CALIBRACION INSTRUMENTAL EXACTA

LABORATORIO DE CALIBRACION

CARTA DE TRAZABILIDAD TEMPERATURA T-103 873.15 K a 1373.15 K (600 °C a 1100,00 °C)

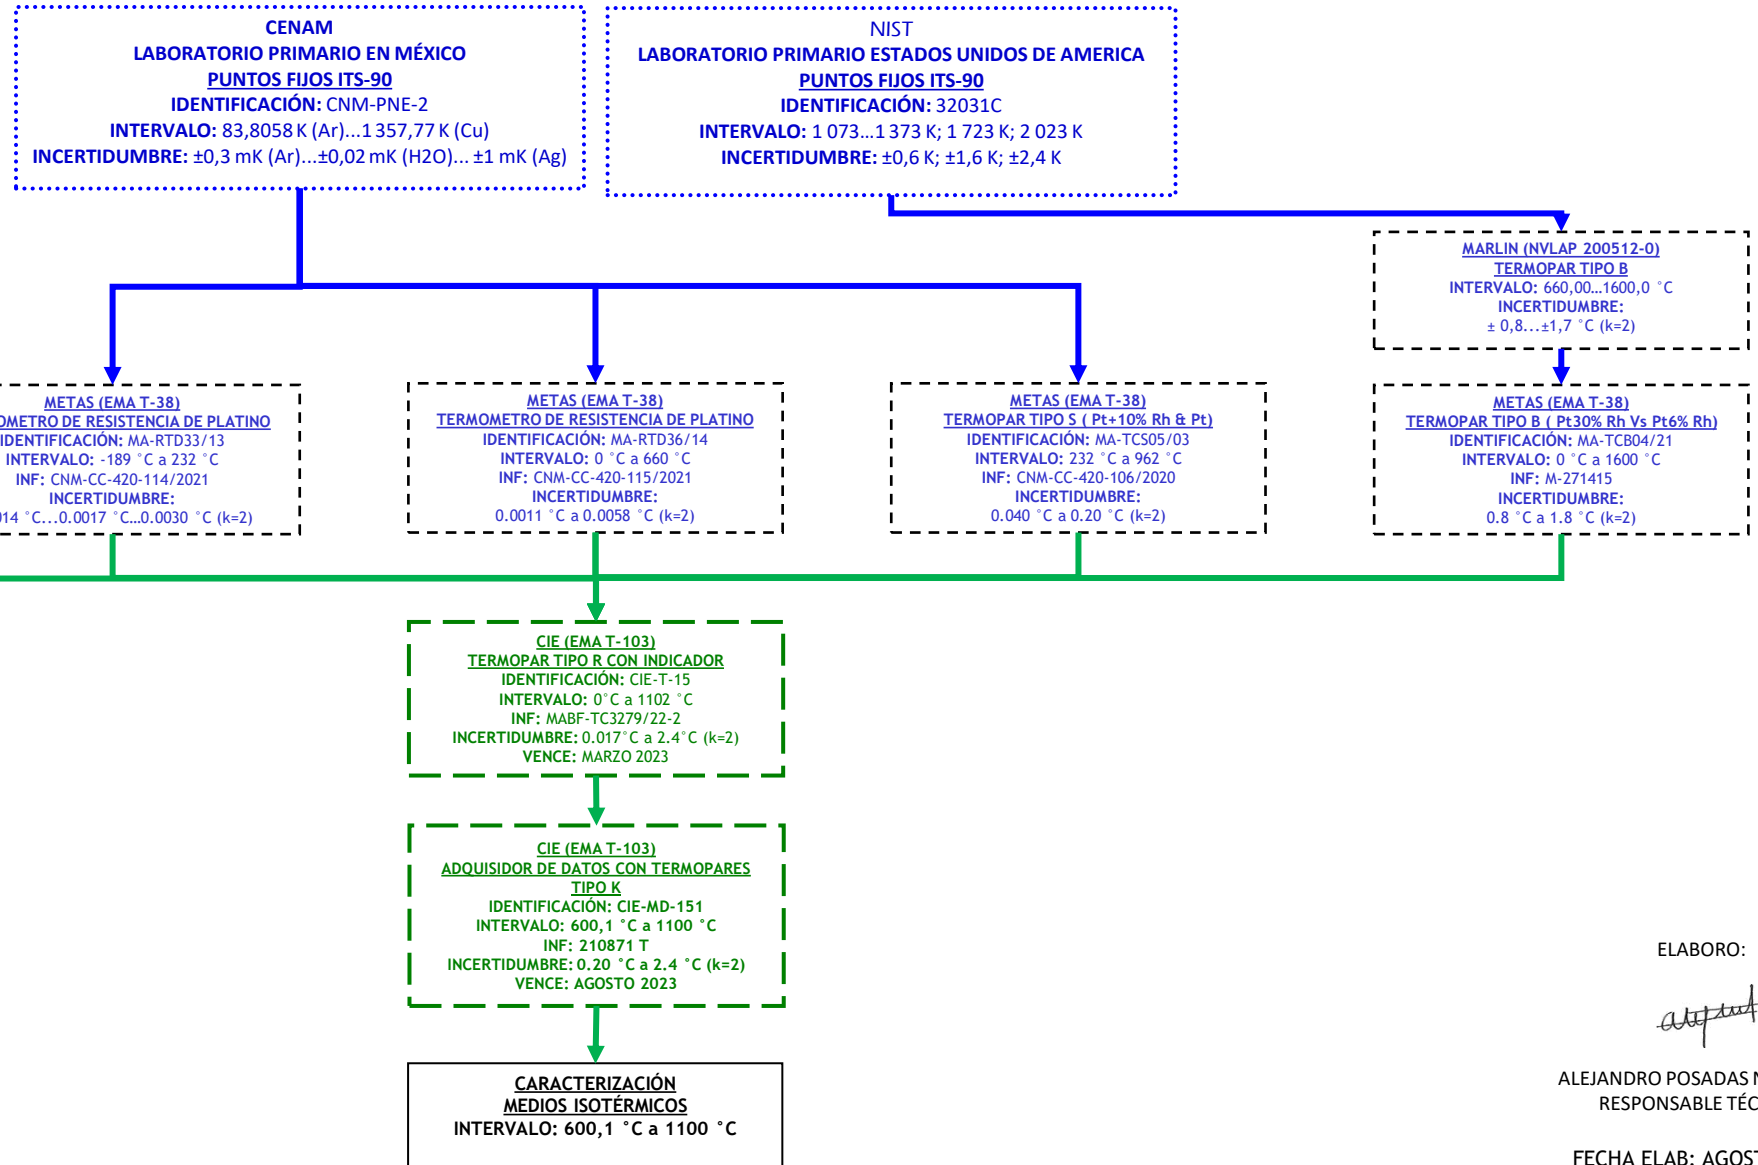

ELABORO:

ALEJANDRO POSADAS NATIVITAS
RESPONSABLE TÉCNICO

FECHA ELAB: AGOSTO 2022

FECHA VENGE: AGOSTO 2023